



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 No. PCE-LP-009-2017  
 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
 Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE CELEBRA CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. PCE-LP-009-2017, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS, LA CUAL SE CELEBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN EL NÚMERO IV DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. PCE-LP-009-2017.

En Chihuahua, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 19 de diciembre de 2017, reunido el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado, el C.P. José Francisco Almanza Alarcón, en su calidad de Presidente; Lic. Martha Elena Chávez Almada, Directora de Finanzas; Lic. María del Refugio Dowz Torres, Coordinadora Jurídica y la Dra. Desiree Sagarnaga Durante, Encargada del Despacho de la Dirección Médica, esta último en su calidad de requirente, quienes se encuentran asistidos por personal médico, técnico y jurídico de Pensiones Civiles del Estado, en el Auditorio de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el segundo piso del Edificio de Consulta Externa con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz N° 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la ciudad de Chihuahua; quienes proceden a llevar cabo la junta de aclaraciones derivada de la licitación pública ya referida, mediante la cual se desahogarán las dudas y planteamientos que se formulen por los participantes de manera clara y precisa, así como hacer constar las respuestas de los mismos.

Para el desarrollo de la presente junta, funge como presidente el **C.P. José Francisco Almanza Alarcón**, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado, quien será apoyado y asesorado por el resto de los integrantes del Comité y el personal especializado de las áreas médicas, técnicas y jurídicas, por ser en su conjunto, las personas que cuentan con los conocimientos necesarios para dar respuesta satisfactoriamente las dudas que surjan en la presente.

Acto seguido el C.P. José Francisco Almanza Alarcón, quien preside este acto, se sirve pasar lista de asistencia a los participantes que se tiene registro que hayan comprado bases de la presente licitación, estando presentes:

No.	CERTIFICADO	PERSONA FÍSICA O MORAL	ASISTENCIA
1	178903	ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES	NO SE PRESENTÓ
2	178962	DEGO FARMACÉUTICA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	PRESENTE



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
LICITACIÓN PÚBLICA  
No. PCE-LP-009-2017  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

No.	CERTIFICADO	PERSONA FÍSICA O MORAL	ASISTENCIA
3	178966	BLANCA LORENA ROMÁN TARANGO	PRESENTE
4	178970	BIOMECHANICAL LABORATORIES, S. DE R.L. M.I.	NO SE PRESENTÓ
5	178996	INDUSTRY CONECT, S.A. DE C.V.	PRESENTE
6	178997	SANDRA ACOSTA OROZCO	PRESENTE
7	179009	GLOBIO, S.A. DE C.V.	PRESENTE
8	179010	ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO	PRESENTE
9	179044	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.	PRESENTE
10	179050	BIOMET MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRESENTE
11	179077	ARITMÉTICA, S.A. DE C.V.	PRESENTE
12	179084	TRAUMASERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	PRESENTE
13	179103	AVANT MEDICAL, S.A. DE C.V.	PRESENTE

Por no existir aclaraciones por parte de la convocante, se da a conocer a los presentes que fueron recibidas por medio electrónico en los términos establecidos en las bases licitatorias, en el numeral IV, LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA ACLARACIÓN DE LAS BASES, preguntas de los licitantes Biomet de México, S.A. de C.V. y Dego Farmacéutica de Chihuahua, S.A. de C.V., y se exhorta a los presentes para que aquello que tengan preguntas que presentar por escrito y en medio magnético, hagan entrega de los mismos, para que una vez que sean integradas a esta acta y debidamente contestadas por la convocante se dé lectura junto con aquellas que fueron realizadas vía correo electrónico, de las bases licitatorias de referencia.

*[Handwritten signatures and initials]*



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
LICITACIÓN PÚBLICA  
No. PCE-LP-009-2017

“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Se dan por recibidos las preguntas por escrito y en medio magnético de: Sandra Acosta Orozco y Globio, S.A. de C.V., mismas que serán respondidas por este Comité previo análisis de sus integrantes y el personal de asesoría que acompaña al mismo.

Con el objeto de dar contestación a las preguntas presentadas por los concursantes, se da contestación a aquellas preguntas que fueron enviadas y presentadas a esta convocante vía electrónica, escrita o magnética, y son las siguientes:

**POR PARTE DE LA MORAL BIOMET MÉXICO, S.A. DE C.V.:**

**Pregunta 1. REQUERIMIENTO EN BASES REFERENTE AL ANEXO A5 CADERA  
PARTIDA 1 CLAVE A5CAD1**

1	A5-CAD1	Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm.. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32 y 34 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm. con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
---	---------	---

Se solicita a la convocante permita ofertar medidas 28mm y 32mm en cabezas metálicas en sustitución a la de 34mm dado que son las medidas estándar en la industria y utilizadas más comúnmente en artroplastias de cadera. Para el caso de la cabeza 36mm metálica se solicita a la convocante permitir la utilización de cabezas de cerámica como equivalencia a este diámetro y con lo cual se minimiza el desgaste por fricción en el acetábulo.

**Con el objeto de generar la libre participación, respetuosamente solicito a la convocante se nos indique si se aceptan las medidas sugeridas**

**Respuesta 1.** Se acepta.

**Pregunta 2. REQUERIMIENTO EN BASES REFERENTE AL ANEXO A5 CADERA  
PARTIDA 3 CLAVE A5CAD3**

3	A5-CAD3	Cadera Primaria Cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 7, 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 32, 34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular Cementada de polietileno de alta densidad, moldeado a compresión y con tetones espaciadores y acabado rugoso en el diámetro externo. Con diámetros internos de 28 y 32 mm. Diámetros externos 48 a 63 mm, en incrementos de 3 mm. Dos cementos para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
---	---------	---

Se solicita a la convocante permita ofertar medidas 28mm y 32mm en cabezas metálicas en sustitución a la de 34mm dado que son las medidas estándar en la industria y utilizadas más comúnmente en artroplastias de cadera. Para el caso de la cabeza 36mm metálica se solicita a



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 No. PCE-LP-009-2017  
 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
 Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

la convocante permitir la utilización de cabezas de cerámica como equivalencia a este diámetro y con lo cual se minimiza el desgaste por fricción en el acetábulo.  
**Con el objeto de generar la libre participación, respetuosamente solicito a la convocante se nos indique si se aceptan las medidas sugeridas**

**Respuesta 2.** Se acepta sin ser limitativo.

**Pregunta 3. REQUERIMIENTO EN BASES REFERENTE AL ANEXO A5 CADERA  
 PARTIDA 5 CLAVE A5CAD4**

5	A5-CAD4	Cadera Primaria Híbrida Vástago Cementado vástago cementado, copa no cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28,32,34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno. En diámetros de 42 a 63 mm., en incrementos de 3 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm , y longitudes de 15 a 40 mm., con incrementos de 5 mm. Cemento para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
---	---------	--

Se solicita a la convocante permita ofertar medidas 28mm y 32mm en cabezas metálicas en sustitución a la de 34mm dado que son las medidas estándar en la industria y utilizadas más comúnmente en artroplastias de cadera. Para el caso de la cabeza 36mm metálica se solicita a la convocante permitir la utilización de cabezas de cerámica como equivalencia a este diámetro y con lo cual se minimiza el desgaste por fricción en el acetábulo.

**Con el objeto de generar la libre participación, respetuosamente solicito a la convocante se nos indique si se aceptan las medidas sugeridas**

**Respuesta 3.** Se acepta sin ser limitativo

**Pregunta 4. REQUERIMIENTO EN BASES REFERENTE AL ANEXO A5 CADERA  
 PARTIDA 4 CLAVE**

4		Cadera Primaria Cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 7, 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Oxido de Zirconia en diámetros de 32, 34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular Cementada de polietileno de alta densidad, moldeado a compresión y con tetones espaciadores y acabado rugoso en el diámetro externo. Con diámetros internos de 28 y 32 mm. Diámetros externos 48 a 63 mm, en incrementos de 3 mm. Dos cementos para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
---	--	---

Se solicita a la convocante permita ofertar medidas 28mm, 32mm y 36mm en cabezas de cerámica como equivalencia al diámetro 34mm dado que son medidas estándar en la industria y de mayor versatilidad en la realización de artroplastias de cadera.

**Con el objeto de generar la libre participación, respetuosamente solicito a la convocante se nos indique si se aceptan las medidas sugeridas**



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 No. PCE-LP-009-2017  
 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
 Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**Respuesta 4:** Se acepta.

**Pregunta 5.** REQUERIMIENTO EN BASES REFERENTE AL ANEXO A5 CADERA  
 PARTIDA 10 CLAVE A5CAD9

10	A5-CAD9	<p><b>Cadera de Revisión con vástago largo cementado</b> Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, y longitud de 250 mm. Con diámetros de 11, 13 15, y 17 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud. con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.</li> <li>- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.</li> <li>- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</li> </ul>
----	---------	---

Se solicita a la convocante permita ofertar un vástago de revisión no cementado como alternativa dado que permite abarcar un mayor espectro de pacientes gracias a los beneficios en recuperación y osteo-integración que implica.

**Con el objeto de generar la libre participación, respetuosamente solicito a la convocante se nos indique si se acepta la propuesta**

**Respuesta 5:** No se acepta.

**Pregunta 6.** REQUERIMIENTO EN BASES REFERENTE AL ANEXO A4-RODILLA  
 PARTIDA 1 CLAVE A4RODI1

4	A4-RODI4	<p><b>Rodilla Revisión con Vástago Largo,</b> Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con modulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos distales y posteriores de 5 y 10 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago de 10, 12, 14, 16 mm. De diámetro por 100, 150, 200 mm. De longitud. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante.- Asesoría de instrumentista para el implante.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</p>
---	----------	---

Se solicita a la convocante la aceptación de la utilización del Polietileno de Alta Densidad Moldeado por Compresión Directa para los insertos solicitados en estas partidas y el cual es una equivalencia con total compatibilidad y congruencia en el sistema de artroplastia de rodilla

**Con el objeto de generar la libre participación, respetuosamente solicito a la convocante se nos indique si se acepta la propuesta**



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 No. PCE-LP-009-2017  
 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
 Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta 6. No se acepta.

**Pregunta 7. REQUERIMIENTO EN BASES REFERENTE AL ANEXO A4-RODILLA  
 PARTIDA 2 CLAVE A4RODI2**

2	A4-RODI2	<p>Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de Oxido de Zirconia modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, o estabilizado posterior, condilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de enlaces cruzados con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesoría de instrumentista para el implante.</li> <li>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.</li> <li>- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.</li> <li>- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</li> </ul>
---	----------	---

Se solicita a la convocante la aceptación de la utilización del Polietileno de Alta Densidad Moldeado por Compresión Directa para los insertos solicitados en estas partidas y el cual es una equivalencia con total compatibilidad y congruencia en el sistema de artroplastia de rodilla.

**Con el objeto de generar la libre participación, respetuosamente solicito a la convocante se nos indique si se acepta la propuesta**

Respuesta 7. No se acepta.

**Respuesta 8. REQUERIMIENTO EN BASES REFERENTE AL ANEXO A4-RODILLA  
 PARTIDA 2 CLAVE A4RODI2**

2	A4-RODI2	<p>Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de Oxido de Zirconia modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, o estabilizado posterior, condilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de enlaces cruzados con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesoría de instrumentista para el implante.</li> <li>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.</li> <li>- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.</li> <li>- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</li> </ul>
---	----------	---

**RODILLA A4RODI2 (Femorales Ceramica o Zirconia):**

Se solicita a la convocante la aceptación de la utilización del metal CoCr para los femorales solicitados en esta partida y el cual es una equivalencia con total compatibilidad y congruencia en el sistema de artroplastia de rodilla, y el cual adicionalmente es el material más utilizado por la industria en estos procedimientos.

**Con el objeto de generar la libre participación, respetuosamente solicito a la convocante se nos indique si se acepta la propuesta**

Respuesta 8. Se acepta.



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 No. PCE-LP-009-2017  
 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
 Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**POR PARTE DE LA MORAL DEGO FARMACÉUTICA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.:**

**Pregunta 1.** Anexo 2 INJERTO DE HUESO. En los requerimientos adicionales del Anexo 2, se solicita garantizar la seguridad en el cumplimiento de métodos de traslado del material (cuándo se requiere red de frío).

¿Qué debemos presentar para garantizar que se lleve a cabo la cadena en frío)

**Respuesta 1.** Deberá presentar bitácora de medición de temperatura desde la salida del producto del almacén, trayecto y entrega del mismo.

**POR PARTE DE SANDRA ACOSTA OROZCO:**

1. **Pregunta 1.** En lo relativo al anexo "A9" partida 6 Clave A9-IMPT6

6	A9-IMPT6	Prótesis de Thompson acero 37 mm hasta 52 mm, con cemento medicado incluido	Set de prótesis de thompson acero	20	50
---	----------	---	-----------------------------------	----	----

¿El cemento medicado se refiere a que lleve antibiótico como gentamicina o trombamicina?

**Respuesta 1.** Gentamicina.

**Pregunta 2.** Se sugiere a la convocante que en las partidas 36, 37,38 y 39 del Anexo "A9" sean cotizadas como un solo sistema, ya que ciertas marcas no son compatibles con otras.

36	A9-IMPT37	Tornillo deslizante de 50 hasta 100 mm rosca de 22 mm DHS	Set placa dhs-dcs	50	200
37	A9-IMPT38	Placa tubo de 4 hasta 12 orificios DHS de 135°	Set placa dhs-dcs	50	200
38	A9-IMPT39	Placa tubo supra condilar de 6 hasta 12 orificios d.c.s de 95°	Set placa dhs-dcs	1	10
39	A9-IMPT40	Tornillo de cierre cabeza hexagonal	Set placa dhs-dcs	1	10

**Respuesta 2.** Se acepta.

**Pregunta 3.** En el caso de "Prótesis de Rodilla Primaria Modular Anatómica" Clave A4-RODI1 del Anexo "B4", en la descripción enumeran las especificaciones puntuales de una marca específica

¿Se aceptan las propuestas de sistemas y medidas equivalentes de otros sistemas (marcas) para el mismo procedimiento?

**Respuesta 3.** Se acepta sin ser limitativa.



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 No. PCE-LP-009-2017  
 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
 Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**Pregunta 4.** En el caso de "Prótesis de Rodilla Primaria Modular Anatómica" Clave A4-RODI1 del Anexo "B4", se solicita componente tibial de titanio.

¿Se acepta propuesta del mismo componente en CrCo (Cromo Cobalto) como el componente Femoral?

1	A4-RODI1	Rodilla Primaria Modular Anatómica, <u>Componente femoral de CrCo</u> modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, condilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. <u>Componente tibial de titanio</u> con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación. - Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	30	200
---	----------	--	----	-----

**Respuesta 4.** Se acepta.

**POR PARTE DE LA MORAL GLOBIO, S.A. DE C.V.:**

**Pregunta 1.** En referencia a la garantía de seriedad de la propuesta, en otras ocasiones se ha permitido presentar únicamente un cheque cruzado en vez de un cheque certificado o póliza de fianza. ¿En esta ocasión también van a permitir presentar un cheque cruzado?

**Respuesta 1.** No, deberá presentar cheque certificado o póliza de fianza en los términos solicitados en las bases licitatorias.

**Pregunta 2.** En la propuesta técnica, en el anexo V requieren una manifestación escrito en donde las empresas participantes en la licitación declaran encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social y requieren que anexemos una constancia emitida por el IMSS. ¿Que procede si la empresa no tiene empleados contratados y por lo tanto legalmente no es requerida a estar inscrita en el Seguro Social?

**Respuesta 2.** Deberá manifestar en el documento del Anexo V que no cuenta con empleados contratados y entregar opinión IMSS donde conste que no está dado de alta como patrón. Adicionalmente si tiene contrato con Outsourcing presentar una copia simple del mismo.





PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 No. PCE-LP-009-2017  
 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
 Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**Pregunta 3.** En el punto 10 de la propuesta técnica, hacen mención de que requieren una relación completa de contratos que se han celebrado con organismos del Gobierno del Estado de Chihuahua, y también requieren copia de estos mismos contratos. En el caso particular de los contratos que se han celebrado con Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en vez de copia de los contratos, ¿aceptarían una carta firmada por un representante de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua donde ratifique el listado de los contratos que han celebrado con la empresa?

**Respuesta 3.** No, deberá exhibir los contratos que ha celebrado con dicha institución en los términos solicitados en las bases licitatorias.

**Pregunta 4.** En la partida "1" con clave "A6-COL1" del Anexo A6 en la descripción dice que se debe de cotizar la "Instrumentación para cervical vía anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo perfil, forma trapezoidal, para 1,2,3 y 4 niveles, dinámica y semicostreñida; con tornillo de titanio autoperforante y autoroscante, de rescate, bicortical, de injerto, con sistema de bloqueo." Ya que cada nivel que requieren cotización requiere diferente cantidad de tornillos, ¿cómo presentamos nuestra propuesta para cada nivel?

**Respuesta 4.** Ofertar equipo completo.

Se apercibe a todos los licitantes que hayan adquirido bases para la presente licitación, que todas las aclaraciones, dudas y cambios realizados emanadas de esta junta de aclaraciones serán obligatorias y deberán ser consideradas para la elaboración de las propuestas técnica y económica y la evaluación de las mismas, bajo pena de no cumplir con ellas, de desechar sus propuestas por no cumplir con los requisitos solicitados por la presente.

No habiendo más preguntas o aclaraciones que realizar, se da por concluida la presente Junta de Aclaraciones, siendo las 16:00 horas del día 19 de diciembre de 2017, firmada de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar, entregando copia de la misma, la cual consta de 11 hojas útiles, para su debida constancia y efectos de notificación.

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,  
 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES  
 CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:


C.P. JOSÉ FRANCISCO ALMANZA ALARCÓN  
 PRESIDENTE



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
LICITACIÓN PÚBLICA  
No. PCE-LP-009-2017  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


  
LIC. MARTHA ELENA CHÁVEZ ALMADA  
DIRECTORA DE FINANZAS  
ASESORA FINANCIERA

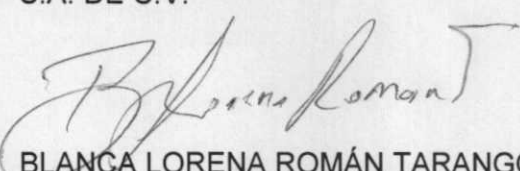
DR. DESIREE SAGARNAGA DURANTE  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN MÉDICA  
REQUIRENTE

LIC. MARÍA DEL REFUGIO DOWZ TORRES  
COORDINADORA JURÍDICA  
ASESORA JURÍDICA


POR LOS LICITANTES

  
DEGO FARMACÉUTICA DE CHIHUAHUA,  
S.A. DE C.V.

  
ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO

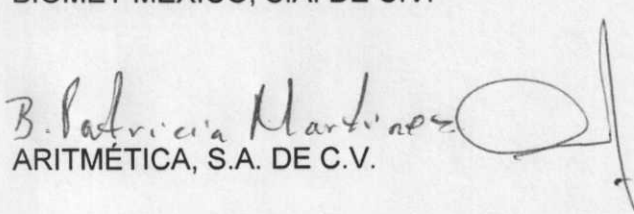
  
BLANCA LORENA ROMÁN TARANGO

  
SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

  
INDUSTRY CONECT, S.A. DE C.V.

BIOMET MÉXICO, S.A. DE C.V.

  
SANDRA ACOSTA OROZCO

  
B. Patricia Martínez  
ARITMÉTICA, S.A. DE C.V.



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
LICITACIÓN PÚBLICA  
No. PCE-LP-009-2017  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

GLOBIO, S.A. DE C.V.

TRAUMASERVICE INTERNATIONAL, S.A.  
DE C.V.

AVANT MEDICAL, S.A. DE C.V.