

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PCE-LPP-013-2021-BIS  
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS  
ANEXO 1  
INSUMOS HALLUX  
PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proveedor: \_\_\_\_\_

| No. Partida | Clave     | Descripción  | Marca | Modelo |
|-------------|-----------|--|-------|--------|
| Unica       | A1-RENT01 | Renta de equipo Osada incluyendo consumibles y zapatos de marcha |       |        |

| Requerimientos adicionales  |
|---|
| El material debera incluir lo siguiente sin costo para la Institución; que consta de motor, micromotor con cable, pieza de mano, raspafina, raspagruesa, dos mangos de bisturí, un elevador de perióstio, 2 hojas de bisturí, y zapato ortopedico |
| Asesoría Técnica para el uso del Equipo.  |
| Asistencia Técnica pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.   |
| Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo (catálogos).   |

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS  
ANEXO 2  
INJERTOS DE HUESO  
PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proveedor: \_\_\_\_\_

| No. Partida | Clave     | Descripción                             | Marca | Modelo |
|-------------|-----------|---|-------|--------|
| 19          | A2-INJH22 | Matriz mineral de hueso bovino 1cc      |       |        |
| 23          | A2-INJH26 | Menisco Der/Izq ext/int                 |       |        |
| 24          | A2-INJH27 | Membrana de colágeno absorbible 15x20mm |       |        |
| 25          | A2-INJH28 | Membrana de colágeno absorbible 20x30mm |       |        |
| 26          | A2-INJH29 | Membrana de colágeno absorbible 30x40mm |       |        |
| 27          | A2-INJH30 | Matriz de colageno                      |       |        |

**Requerimientos adicionales**

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.


En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.



Nombre del Proveedor: \_\_\_\_\_

| No. Partida | Clave    | Descripción   | Marca | Modelo |
|-------------|----------|---|-------|--------|
| 7           | A6-COL6  | Implante para reemplazo vertebral telescópicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio. |       |        |
| 13          | A6-COL10 | Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada.   |       |        |
| 16          | A6-COL13 | Sistema de vertebroplastia.   |       |        |

| Requerimientos adicionales   |
|--|
| Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocación de los implantes                         |
| Asesoría de instrumentista para el implante.   |
| Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  |
| Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal.   |
| Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.  |
| <b>Todos los componente deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las especificadas.</b> |
| Las partidas 1 y 2 deberan ser adjudicadas al mismo proveedor, al igual que la partida 9, 10 y 11                    |

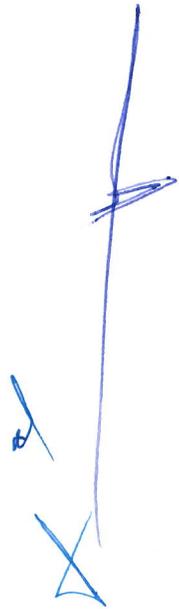Nombre del Proveedor: \_\_\_\_\_

| No. Partida | Clave   | Descripción   | Marca | Modelo |
|-------------|---------|---|-------|--------|
| 4           | A7-HOM4 | Cabeza Humeral con extensión para tratamientos de lesiones de manguito rotador tipo CTA.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.<br>- Asesoría de instrumentista para el implante.<br>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.<br>- Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal.<br>- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. |       |        |
| 6           | A7-HOM6 | ESPACIADORES SUBACROMIALES (chico, mediano y grande)  |       |        |

**Requerimientos adicionales**

Quando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior únicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder el importe máximo adjudicado.

El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas deberá proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realización del procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.

Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.


Asesoría de instrumentista para el implante.

Asistencia técnica, pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.

Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas.

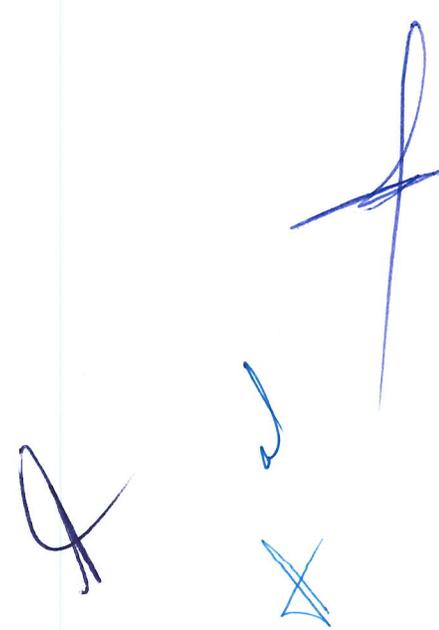

Nombre del Proveedor:

| No. Partida | Clave     | Descripción   | Sistema                                    | Marca | Modelo |
|-------------|-----------|---|--|-------|--------|
| 8           | A9-IMPT9  | <b>Set de acetabulo y pelvis.</b>   | <b>Set de acetabulo y pelvis.</b>          |       |        |
|             |           | Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro. número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.   |  |       |        |
|             |           | Placas para reconstrucción, curva moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro. número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  |  |       |        |
|             |           | Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.   |  |       |        |
|             |           | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.   |  |       |        |
|             |           | brocas y destornillador para pelvis   |  |       |        |
|             |           | Separadores hohmann   |  |       |        |
|             |           | tornillos canulados 6.5 y 7.0 mm de diámetro  |  |       |        |
|             |           | triscadores   |  |       |        |
|             |           | set de pinzas de reducción  |  |       |        |
|             |           | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  |  |       |        |
| 11          | A9-IMPT12 | <b>Protesis tarsales.</b><br><b>Endoprótesis tarsal de titanio de 8 a 12 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de</b>   | <b>Protesis tarsales.</b>                  |       |        |
|             |           | <b>Placa gancho anatómica para cadera.</b>  | <b>Placa gancho anatómica para cadera.</b> |       |        |
|             |           | Placas anatomicas bloqueadas 4.5/5.0 mm para femur proximal tipo gancho de contacto limitado de izquierda a derecha. Porcion proximal de la placa premoldeada para adaptarse al femur proximal. Orificios proximales para tornillos canulados de bloqueo de 7.3 mm, tercer agujeros para tornillos canulados de bloqueo de 5.0 mm. Angulación con respecto al cuerpo de la placa: Primer agujero proximal (7.3 mm) 95°, segundo agujero proximal (7.3 mm) 120°, tercer agujero proximal (5.0 mm) 135°. Longitud de 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. |  |       |        |
|             |           | Tornillo de bloqueo de 7.3 mm, canulado, de aleación de titanio o acero inoxidable, autopercutor, para placa bloqueada. Longitud de 30 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  |  |       |        |
|             |           | Tornillos de bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.   |  |       |        |
|             |           | Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  |  |       |        |
|             |           | Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.   |  |       |        |
|             |           | Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.   |  |       |        |
|             |           | Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  |  |       |        |
|             |           | Avellanador 4.5/6.7   |  |       |        |
|             |           | Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm   |  |       |        |

IMPLANTES PARA TRAUMA  
PROPUESTA TÉCNICA


Nombre del Proveedor: \_\_\_\_\_

| No. Partida   | Clave     | Descripción   | Sistema   | Marca | Modelo |
|---|-----------|---|---|-------|--------|
| 14  | A9-IMPT15 | Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm   |   |       |        |
|   |           | Cinceles de lambotte  |   |       |        |
|   |           | Cizaya  |   |       |        |
|   |           | Cucharillas   |   |       |        |
|   |           | Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5  |   |       |        |
|   |           | Elevador de periostio 15 mm   |   |       |        |
|   |           | Elevador de periostio 9 mm  |   |       |        |
|   |           | Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5  |   |       |        |
|   |           | Gubias  |   |       |        |
|   |           | Guia de broca doble 4.5 /6.5  |   |       |        |
|   |           | Guia para tornillo 7.3 mm   |   |       |        |
|   |           | Guia neutra excentrica 3.2  |   |       |        |
|   |           | Legra   |   |       |        |
|   |           | Machuelo 4.5 mm de acople rapido  |   |       |        |
|   |           | Machuelo 6.5 mm de acople rapido  |   |       |        |
|   |           | Machuelo con mango en t 4.5 mm  |   |       |        |
|   |           | Machuelo con mango en t 6.5 mm  |   |       |        |
|   |           | Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque   |   |       |        |
|   |           | Martillo  |   |       |        |
|   |           | Medidor de profundidad grande   |   |       |        |
|   |           | Osteotomos  |   |       |        |
|   |           | Pinza lowman  |   |       |        |
|   |           | Pinza multidentada 22 cm  |   |       |        |
|   |           | Pinza tipo campo mediana 19 mm  |   |       |        |
|   |           | Pinza verbruge  |   |       |        |
|   |           | Pinzas autocentrante 26 cm largo  |   |       |        |
|   |           | Protector de piel p/ 3.5 y 4.5  |   |       |        |
|   |           | Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido  |   |       |        |
|   |           | Separador benett  |   |       |        |
|   |           | Separador howmann chicos  |   |       |        |
|   |           | Separador howmann grandes   |   |       |        |
|   |           | Separador volkmann  |   |       |        |
| Triscadores para grandes fragmentos   |           |   |   |       |        |
| Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck |           |   |   |       |        |
| Baterias recargables para equipo de poder   |           |   |   |       |        |
| Cargador para baterias recargables  |           |   |   |       |        |
| 37  | A9-IMPT38 | <b>Grapas blount acero.</b><br><b>Grapas blount acero, tamaño chica, mediana y grande. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las</b>   | Grapas blount acero.                                      |       |        |
| 38  | A9-IMPT39 | <b>Placa anatomica bloqueada pediatrica.</b><br><b>Placa anatomica bloqueada pediatrica. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de</b>   | Placa anatomica bloqueada pediatrica.                     |       |        |
| 39  | A9-IMPT40 | <b>Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial.</b><br><b>Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.</b> | Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. |       |        |
| 44  | A9-IMPT45 | Stop calcaneo de titanio, con clavo guía, broca iniciadora de 15 mm a 30 mm   |   |       |        |

| Requerimientos adicionales  |
|---|
| Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.                            |
| En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjudicado. |
| Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes   |
| Asesoría de instrumentista para el implante.  |
| Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.   |

Nombre del Proveedor: \_\_\_\_\_

| No. Partida | Clave | Descripción  | Sistema | Marca | Modelo |
|-------------|-------|--|---------|-------|--------|
|             |       | Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.   |         |       |        |
|             |       | Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.  |         |       |        |
|             |       | Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material  |         |       |        |
|             |       | Todo el material y equipo debe contar con certificacion internacional de calidad   |         |       |        |
|             |       | TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.  |         |       |        |
|             |       | Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado. |         |       |        |

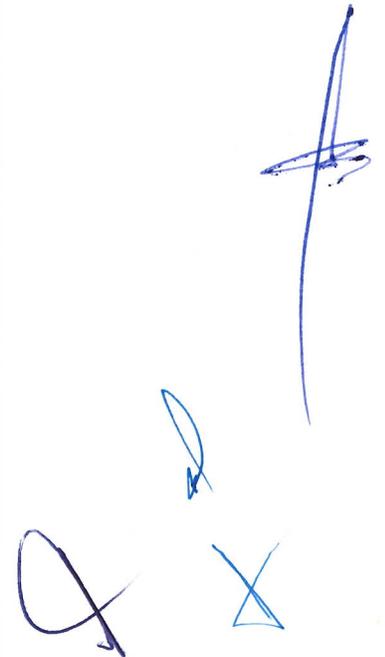



ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

ANEXO 9

IMPLANTE MAMARIO

PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proveedor: \_\_\_\_\_

| No. Partida | Clave     | Descripción                                | Marca | Modelo |
|-------------|-----------|--|-------|--------|
| UNICA       | sin clave | Implante mamario nanotexturizado anatómico |       |        |
|             | sin clave | Expansor mamario nanotexturizado           |       |        |

Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior únicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder el Precio Unitario ofertado.



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PCE-LPP-013-2021-BIS  
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS  
ANEXO 11  
IMPLANTES PARA OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA  
PROPUESTA TÉCNICA



Nombre del Proveedor: \_\_\_\_\_

| No. Partida | Clave      | Descripción                                      | Sistema       | Marca | Modelo |
|-------------|------------|--|---------------|-------|--------|
| 1           | A11-OIOF1  | Prótesis estapedectomia varias medidas           | Otorrino      |       |        |
| 2           | A11-OIOF2  | Prótesis de schuknecht varias medidas            | Otorrino      |       |        |
| 3           | A11-OIOF3  | Prótesis boton septal 3cm                        | Otorrino      |       |        |
| 4           | A11-OIOF4  | Prótesis piston smart varias medidas             | Otorrino      |       |        |
| 5           | A11-OIOF5  | Prótesis porp varias medidas                     | Otorrino      |       |        |
| 6           | A11-OIOF6  | Lente de 3 piezas con dioptria de varias medidas | Oftalmología  |       |        |
| 7           | A11-OIOF7  | Válvula ahmed flexible                           | Oftalmología  |       |        |
| 8           | A11-OIOF8  | Pesario de anillo con soporte varias medidas     | Urología      |       |        |
| 9           | A11-OIOF9  | Pesario de dona varias medidas                   | Urología      |       |        |
| 10          | A11-OIOF10 | Malla transvaginal                               | Urología-gine |       |        |
| 11          | A11-OIOF11 | PROTESIS TORP VARIAS MEDIDAS                     | OTORRINO      |       |        |
| 12          | A11-OIOF12 | Set de Montgomery para timpanoplastica           | OTORRINO      |       |        |
| 13          | A11-OIOF13 | Lente de 4 piezas con dioptria de varias medidas | Oftalmología  |       |        |
| 14          | A11-OIOF14 | Set de Montgomery para cuerdas bocales           | Otorrino      |       |        |

| Requerimientos adicionales   |
|--|
| Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.                           |
| En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el Precio unitario ofertado. |
| TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.  |
| LOS LENTES DE 3 PIEZAS, SE REQUERIRÁN SEGÚN LAS DIOPTRIAS POR DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN LA NECESIDAD DEL PACIENTE DESDE LA 17 A LA 23.5  |