



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE CELEBRA CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO, LA CUAL SE CELEBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VI, 58 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN EL NÚMERO III DE LAS BASES DE LICITATORIAS RECTORAS DEL PROCESO.

En Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 6 de mayo de 2022, reunido el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, integrado por el C.P. Federico Acevedo Muñoz, Suplente del Presidente; L.A.F. Luis Carlos Payán Armendáriz, en representación del Director de Finanzas, en calidad de Vocal; Lic. Jorge Alberto Rodríguez Meléndez, Coordinador Jurídico, en calidad de Vocal, y la Dra. Alicia Andrea Rivera Morales, en representación del Director Médico, como Vocal y Requirente de los bienes, contando con la presencia del Lic. Ricardo de Jesús Pérez Peña, titular del Órgano Interno de Control de Pensiones Civiles del Estado, en calidad de observador, en el Auditorio ubicado en planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz, Número 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la ciudad de Chihuahua; quienes proceden a llevar cabo la junta de aclaraciones derivada de la licitación pública ya referida, mediante la cual se desahogarán las dudas y planteamientos que se formulen por los participantes de manera clara y precisa, así como hacer constar las respuestas de los mismos.

Para el desarrollo de la presente junta funge como presidente el C.P. Federico Acevedo Muñoz, Suplente del Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado, quien será apoyado y asesorado por el resto de los integrantes del Comité y el personal especializado de las áreas médica, técnica y jurídica, por ser en su conjunto, las personas que cuentan con los conocimientos necesarios para dar respuesta satisfactoriamente los cuestionamientos y dudas que fueron planteados por los licitantes en los términos de las bases licitatorias rectoras del proceso.

Acto seguido el C.P. Federico Acevedo Muñoz en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59, fracciones III y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el artículo 53 de su Reglamento, pone en conocimiento que quienes envió escrito vía electrónica, en el que expresa su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de una o un tercero, manifestando los datos generales de la persona interesada y, en su caso, de quien funge como representante, en los términos del numeral III de las bases rectoras del procedimiento, son los siguientes licitantes:

1. Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Materiales para Hospitales, S.A. de C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

2. Laboratorios Licón, S.A.
3. Biomérieux México, S.A. de C.V.
4. Ortho Clinical Diagnostics México Operations, S. de R.L de C.V.
5. Instrumentos y Equipos Falcon, S.A. de C.V.
6. Laboratorios San Ángel, S.A.

Debido a lo anterior, se les dará respuesta a las aclaraciones que fueron recibidas vía electrónica a los correos que fueron proporcionados en las bases licitatorias.

ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE

Por otro lado, la convocante desea realizar aclaraciones a las bases rectoras del proceso, lo cual hace en los siguientes términos:

Se aclara el lugar y hora de celebración del acto de presentación y apertura de propuestas para quedar de la siguiente manera: El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo en un solo acto y tendrá verificativo el día **12 de mayo de 2022**, a las **11:00 horas**, en presencia de los licitantes, en el **Auditorio de Pediatría, ubicado en la planta alta del Edificio de Consulta Externa** de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Resaltando que el acceso a los licitantes a dicha instalación se cerrará en punto de la hora señalada.

Por no haber más aclaraciones por parte de la convocante, se procede a dar contestación a las dudas que presentó el licitante vía electrónica y que además cumple con el requisito de presentar el escrito en el que manifiestan su deseo de participar en la licitación en los términos arriba ya mencionados, contestación que se da en los términos siguientes:

Por parte de COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS COAGULACIÓN.

SOLICITAN: PUNTO 11 Que cuente con cubetas de reacción desechables.

PREGUNTA: Solicitamos a la amable convocante, poder ofertar equipo que trabaje con rotores de acrílico de 20 cubetas de reacción cada uno, eliminando la necesidad de manipular múltiples cubetas individuales, **¿SE ACEPTA?**



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta 1. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 2. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS

Punto 5 Solicitan Por método de Inmuncromatografía.

Pregunta: Es correcto entender a equipo automatizado portátil que utiliza tarjetas, que incluyen todos los reactivos necesarios para la inmunoanálisis cromatográfica con método de lectura por inmunofluorescencia, lo que permite obtener resultados cuantitativos. ¿Es correcta nuestra apreciación? ¿Se acepta?

Respuesta 2. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 3. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS

Punto 6. Solicitan. Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automático de aguja.

Pregunta. Nuestro equipo por ser un equipo automatizado que utiliza tarjetas individuales y la carga de la muestra se realiza de manera manual con un volumen aproximado de 250 a 300 µl, de sangre total o plasma, volumen que, al ser dispensado en el área de depósito de muestra, con el uso de una pipeta de transferencia desechable, que bien incluida en el kit de reactivo, este corre de manera homogénea evitando cualquier interferencia durante su elución, obteniendo resultados confiables. Tecnología que actualmente utilizan en sus los hospitales solicitantes, ór lo que solicitamos que la detección de burbujas y la limpieza automática de la aguja sean opcionales. ¿Se acepta?

Respuesta 3. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 4. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS

Punto 7. Solicitan Control de calidad integrado con estadísticas en dos niveles.

Pregunta es correcto entender a equipo con capacidad de solución integral para monitorizar y proporcionando informes de datos, control del medidor, del usuario y análisis de CC con calibración de ensayo especifica lote (a través del módulo CODE CHIP específico del lote), ¿es correcta nuestra apreciación? ¿Se acepta?

Respuesta 4. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 5. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS

Punto 10. Solicitan Que el operador no tenga contacto con los desechos infectocontagiosos (Sistema cerrado).

Pregunta. Nuestro equipo utiliza tarjetas individuales desechables que favorecen a una mínima manipulación, mínimo riesgo de contaminación sin merma de reactivo. ¿Con estas características cumplimos con lo solicitado? ¿Se acepta?



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta 5. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 6. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

AUTOINMUNIDAD Punto 14. Solicitan. Se deberá contar con un Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para las patologías detectadas microscópicamente por la técnica de inmunofluorescencia:

Pregunta Podemos ofertar Microscopio de fluorescencia con sistema óptico plano cromático con revolver de 5 posiciones, objetivos de 4X/10x/40x/100 x aceite, Cabezal binocular de 360°, ocular WF 10X/22mm, con rango de ajuste de dioptrías +/-5, inclinación de 30°; Iluminación fluorescente LED 3W intensidad ajustable, led de larga duración 100000h, con sistema de enfoque con graduación de movimiento de 2µm, Platina que permite el uso de hasta dos porta objetos simultáneamente, con movimiento de platina por rodillo con tope y revestimiento anti rayaduras y condensador Abbe con soporte de filtro. ¿Se acepta?

Respuesta 6. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 7. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

AUTOINMUNIDAD Punto 16. Solicitan. Platina provista de carro con movimiento en X-Y, condensador con apertura numérica.

Pregunta: Se le pide a la convocante poder ofertar un condensador con apertura tipo iris que permite controlar el diámetro y el punto focal del cono de luz que atraviesa la muestra ¿se acepta?

Respuesta 7. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 8. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

AUTOINMUNIDAD Punto 17. Solicitan. pi iluminador estándar de AFL diafragma de campo. Fuente de luz de halógeno. Transformador integrado con regulación de intensidad sin escalas.

Pregunta. Se le pide a la convocante poder ofertar fuente de iluminación de tecnología LED, ¿se acepta?

Respuesta 8. Se acepta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Pregunta 9. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS AUTOINMUNIDAD Punto 18. Solicitan

Sistema de enfoque coaxial. Macrométrico y Micrométrico.

Pregunta. Entendemos por macrométrico y micrométrico como perillas para enfoque grueso y fino, es correcta nuestra apreciación. ¿se acepta?

Respuesta 9. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 10. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS Punto 9 Que integre en un solo paquete soluciones, calibradores y contenedor de desecho,

Nuestro equipó emplea pruebas individuales en tarjetas, que incluyen los reactivos, así como el control de calidad que verifica y valida la calidad de los resultados con principio de inmunocromatográfica de fluorescencia, a de más que el equipo se calibra de manera automática ¿con estas características cumplimos con lo solicitado? ¿Se acepta?

Respuesta 10. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 11. PROPUESTA TECNICA ANEXO “A” – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Punto 2 EQUIPAMIENTO Solicitan equipos de última tecnología que no se encuentren en vías de ser discontinuados y estén al 100% de sus funciones de forma comprobable, nuevos o usados, no mayor a 5 años de antigüedad de fabricación.

Podemos ofertar equipos de última tecnología en condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando resultados confiables y trazables. ¿Se acepta?

Respuesta 11. Se acepta, siempre y cuando no exceda los años solicitados de antigüedad.

Pregunta 12. ANEXO I "PROPUESTA TÉCNICA". ANEXO A "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS". EQUIPO DE HEMATOLOGÍA, No. 2. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un instrumento de alta tecnología, que procesa hasta 119 muestras por hora en un solo módulo. ¿se acepta?

Respuesta 12. Se acepta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO"

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Pregunta 13. ANEXO I "PROPUESTA TÉCNICA". ANEXO A "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS". EQUIPO DE GASOMETRÍA, No. 3. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que utiliza cartuchos desechables de uso único para su operación, los cuales contienen todos los reactivos necesarios para su funcionamiento y que permiten menor desperdicio de materiales cuando no son utilizados. ¿Se acepta?

Respuesta 13. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 14. ANEXO I "PROPUESTA TÉCNICA". ANEXO A "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS". EQUIPO DE GASOMETRÍA, No. 4. Para no impedir la libre competencia, se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo para gasometría que mide los parámetros pH, pCO₂, pO₂, HCO₃, sO₂, TCO₂, EB y Lactato en cartucho desechable de un solo uso, conteniendo los parámetros más importantes para la determinación de gasometría y con la ventaja de ser portátil, pudiendo ser utilizado directamente a la cabecera del paciente, reduciendo riesgos en el manejo de muestras y mejorando la calidad de los resultados para los pacientes. ¿Se acepta?

Respuesta 14. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 15. ANEXO I "PROPUESTA TÉCNICA". ANEXO A "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS". EQUIPO DE GASOMETRÍA, No. 11. Se solicita a la convocante se nos permita ofertar un equipo que realiza de forma automática una calibración a un punto en cada uso, permitiendo realizar mediciones de control de calidad cuando el usuario así lo requiera (bajo demanda). ¿Se acepta?

Respuesta 15. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 16. PUNTO VIII "INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS", PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 17. COPIA DE LICENCIA SANITARIA VIGENTE. A ESTE RESPECTO, ESTE DOCUMENTO NO APLICA PARA DISTRIBUIDORES, TENIENDO COMO EQUIVALENTE EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN Y EL DE RESPONSABLE SANITARIO, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ESTOS ÚLTIMOS DOCUMENTOS PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO SOLICITADO ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Respuesta 16. Se acepta.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Pregunta 17. PUNTO VIII “INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS”, PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 15. CURRÍCULUM DE LA EMPRESA. SE SOLICITA SEÑALAR CONTRATOS SIMILARES EN CUANTO A BIENES OFERTADOS, CANTIDAD Y MONTO QUE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE PÚBLICO O PRIVADO. A ESTE RESPECTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿CUÁNTOS CONTRATOS SERÁ NECESARIO SEÑALAR? ¿SERÍAN SUFICIENTES 5 CONTRATOS? DE LA MISMA MANERA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿SERÍA SOLAMENTE NECESARIO MENCIONARLOS, O SERÍA NECESARIO ENTREGAR COPIA DE LOS MISMOS? FAVOR DE ACLARAR

Respuesta 17. Se acepta señalar 5 contratos, sin ser limitativo, también, no es necesario entregar copia de los mismos, únicamente basta con indicar los datos generales del contrato.

Pregunta 18. ANEXO II “PROPUESTA ECONÓMICA”. EN EL FORMATO PROPORCIONADO, EN EL APARTADO “CANTIDAD TOTAL (36 meses)” se muestra una numeración de partidas que no sigue una secuencia. ejemplo: partida 3 hematología, partida 5 uroanálisis. es decir, de la partida 3 se salta a la partida 5. esto no sucede en el apartado anterior “desglosado anual” en dónde sí se sigue la secuencia numérica correcta, por lo que solicitamos a la convocante nos aclare si sería necesario corregir los números de las partidas para que sean las 11 soliaictadas y no 12 cómo se muestra actualmente. favor de aclarar

Respuesta 18. Si será necesario acomodar las partidas, sin embargo, si un proveedor no realiza esta corrección no será motivo de desechamiento.

Pregunta 19. ANEXO I “PROPUESTA TÉCNICA”. ANEXO A “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS”. EQUIPO lector de marcadores cardiacos. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita SUBRRROGAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A ESTE EQUIPO PARA EL HOSPITAL CD. JUÁREZ, YA QUE EL VOLUMEN DE PRUEBAS SOLICITADAS ES POCO Y ESTO INCREMENTARÍA EL COSTO DE LA PROPUESTA. ¿se acepta ESTA PROPUESTA?

Respuesta 19. Se acepta, siempre y cuando no afecte en el tiempo de entrega del resultado y si la demanda aumenta se pueda contar con la posibilidad de instalar un equipo para su proceso.

Pregunta 20. ANEXO I “PROPUESTA TÉCNICA”. ANEXO A “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS”. EQUIPO DE AUTOINMUNIDAD. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita SUBRRROGAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A ESTE EQUIPO PARA EL HOSPITAL CHIHUAHUA, YA QUE EL VOLUMEN DE PRUEBAS SOLICITADAS ES POCO Y ESTO INCREMENTARÍA EL COSTO DE LA PROPUESTA. ¿se acepta ESTA PROPUESTA?





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta 20. Se acepta, siempre y cuando no afecte en el tiempo de entrega del resultado y si la demanda aumenta se pueda contar con la posibilidad de instalar un equipo para su proceso.

Pregunta 21. ANEXO I "PROPUESTA TÉCNICA". ANEXO A "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS". EQUIPO DE BIOLOGÍA MOLECULAR. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita SUBRRROGAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A ESTE EQUIPO PARA EL HOSPITAL CHIHUAHUA, YA QUE EL VOLUMEN DE PRUEBAS SOLICITADAS ES POCO Y ESTO INCREMENTARÍA EL COSTO DE LA PROPUESTA. ¿se acepta ESTA PROPUESTA?

Respuesta 21. Se acepta, siempre y cuando no afecte los tiempos de entrega del resultado.

Por parte de LABORATORIOS LICÓN, S.A.:

Pregunta 1. ANEXO A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS. COAGULACION. 5. Los controles y calibradores deberán ser liofilizados. Dado que hay equipos que tienen pruebas precalibradas por parte del fabricante, lo cual, favorece en el costo de la prueba ya que no es requerido el uso de calibrador; Se solicita a la convocante permita ofertar reactivo precalibrado que no requiera calibrador liofilizado. ¿Se acepta?

Respuesta 1. Se acepta, siempre y cuando aseguren que los controles de calidad son confiables, demostrándose con la documentación correspondiente que incluya valores de referencia dentro de rango, insertos, etc.

Pregunta 2. ANEXO A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS. INMUNOHEMATOLOGIA. 1. El equipo deberá contar con un Sistema compacto 2 en 1 integrado con la tecnología de aglutinación en columna. Dado que las características solicitadas corresponden a una marca en específico, limitando la libre participación y de acuerdo al Artículo 48, 53 y 56 de la "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua". Indica, que no deberá limitar la libre participación. Se solicita a la convocante permita ofertar equipo manual, el cual, consta de una centrifuga automática y de un incubador para la aglutinación en columna. ¿Se acepta?

Respuesta 2. Se acepta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Pregunta 3. ANEXO A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. INMUNOHEMATOLOGÍA. 2. El equipo deberá contar con una centrifuga con capacidad máxima de 10 casetes. Dado que las características solicitadas corresponden a una marca en específico limitando la libre participación y de acuerdo al Artículo 48, 53 y 56 de la “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua”. Indica, que no deberá limitar la libre participación. Se solicita a la convocante permita ofertar centrifuga con capacidad de 24 tarjetas de gel. ¿Se acepta?

Respuesta 3. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 4. ANEXO A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. INMUNOHEMATOLOGÍA. 3. El equipo deberá contar con incubador con capacidad máxima de 10 casetes. Dado que las características solicitadas corresponden a una marca en específico limitando la libre participación y de acuerdo al Artículo 48, 53 y 56 de la “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua”. Indica, que no deberá limitar la libre participación, se solicita a la convocante permita ofertar incubador con capacidad de 24 tarjetas de gel y 24 tubos de muestra. ¿Se acepta?

Respuesta 4. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 5. ANEXO A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. QUÍMICA CLÍNICA. HEMOGLOBINA GLICOSILADA. Se solicita a la convocante permita ofertar equipo de Electroforesis Capilar para esta prueba, la cual, permitirá detectar variantes de hemoglobina y/o diagnóstico de alfa o beta talasemias con el parámetro de HbA2. ¿Se acepta?

Respuesta 5. Se acepta, siempre y cuando el equipo sea 100% automatizado y que el personal químico no tenga contacto directo con la muestra y se emplee tubo primario, que el equipo cuente con automuestreador, ya que por la cantidad de muestras que se procesan no es viable el proceso manual.

Pregunta 6. ANEXO A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. HEMATOLOGÍA. ERITROSEDIMENTACIÓN GLOBULAR. Se solicita a la convocante permita ofertar sistema que correlaciona con el método Westergren modificado, en el cual, obtendrá resultado en 30 minutos, sin necesidad de realizar alguna corrección. ¿Se acepta?





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta 6. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 7. ANEXO A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. INMUNOHEMATOLOGIA. GRUPO Y FACTOR RH (ABO/RH). Es corrector entender que se deberá incluir en la determinación de grupo sanguíneo y factor Rh, las pruebas directas Anti A, Anti B, Anti AB, Anti D y Control, así como también las inversas utilizando eritrocitos con antígeno A1 y B, tal como lo establece el inciso a) del punto 9.5.2 .1 de la NOM-253-SSA1-2012. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta 7. Es correcta su apreciación.

Pregunta 8. ANEXO A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. INMUNOHEMATOLOGIA. PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN CASETE. Dado que las características solicitadas corresponden a una marca en específico limitando la libre participación y de acuerdo al Artículo 48, 53 y 56 de la “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua”. Indica, que no deberá limitar la libre participación, se solicita a la convocante permita ofertar Prueba de compatibilidad en tarjeta de gel. ¿Se acepta?

Respuesta 8. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 9. PROPUESTA TÉCNICA. 16. Copia simple del Registro Sanitario ante la Secretaría de Salud (Anexos y última modificación) para la comercialización de cada uno de los productos, consumibles y equipos a licitar, de conformidad con los artículos 376 y 376 bis de la Ley General de Salud.

Se solicita a la convocante que para aquellos reactivos, insumos y/o equipos que debido a su naturaleza no requieren de un registro sanitario, nos permita presentar únicamente el “listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”. **PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. Señalando los productos a los que les aplique. ¿Se acepta?**

Respuesta 9. Se acepta.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO"

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Por parte de **BIOMÉRIEUX MÉXICO S.A. DE C.V.:**

Pregunta 1. REFERENCIA. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO POR TIPO DE ANÁLISIS, MICROBIOLOGIA Pág. 14

PREGUNTA. - Para fomentar la libre participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo para microbiología con las siguientes características:

1. Sistema automatizado para la identificación y susceptibilidad de bacterias (Cocos y Bacilos) y levaduras presentes en muestras de pacientes.
2. Tarjetas de Identificación con sustratos bioquímicos liofilizados y tarjetas de susceptibilidad con concentraciones variables de antibióticos que determinan la concentración mínima inhibitoria (CMI), ya listas para su para poder realizar la identificación y susceptibilidad.
3. Capaz de realizar pruebas de identificación y susceptibilidad de bacterias Gram Positivas, Gram Negativas y Levaduras a través de colorimetría y turbidez, respectivamente
4. Sin necesidad de reactivos reveladores adicionales.
5. Despliegue de reporte de antibiogramas y alertas de resistencia en base a reglas CLSI actuales.
6. Software en español para procesar la información, para la validación de los antibiogramas o resistencias cruzadas, frecuencia de las cepas, reportes epidemiológicos y estadísticos.
7. Que permita edición y revisión de resultados de cualquier paciente y en cualquier momento.
8. Control de calidad incluido utilizando cepas ATCC
9. Que incluya software epidemiológico
10. Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.

Respuesta 1. Se acepta sin ser limitativa.

Por parte de **ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S. DE R.L DE C.V.:**

Pregunta 1. Punto e. Escrito del fabricante en el que manifieste que no existe ninguna restricción para el uso de su equipo médico, en el país de origen o internacionalmente.

Solicitamos de la manera más atenta al convocante nos informe si dicha carta puede ser firmada por la empresa filial del fabricante, titular del registro sanitario en México y /o distribuidor primario en México ¿se acepta?

Respuesta 1. Se acepta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Pregunta 2. Punto 3. INSTALACIÓN. 5. Manual de usuario en español (1 impreso y 1 CD-ROM o USB) y 6. Manual de servicio en español (1 impreso y 1 CD-ROM o USB)

Solicitamos de la manera mas atenta al convocante que en caso de que le fabricante solo cuente con un Manual de Referencia orientado al usuario del equipo (que incluye descripción de uso y manejo del equipo, así como puntos de servicio y mantenimiento del equipo), permita entregar para los dos puntos solo una copia de dicho manual. ¿se acepta?

Respuesta 2. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 3. Anexo “A”, características técnicas de los equipos, Química Clínica, punto 1: Con capacidad promedio de procesamiento deberá ser de 1,000 a 2,000 pruebas por hora para Chihuahua y 300 - 400 pruebas por hora para Juárez

¿Es correcto entender que la capacidad de 1000 a 2000 pruebas por hora para Chihuahua, se refiere a la suma de la productividad de los dos equipos solicitados para esta delegación?

Respuesta 3. Se solicitan dos equipos para tener uno de respaldo ya que en ocasiones la atención técnica puede tardar más de 4 horas y detiene el trabajo del área, pero si se proponen dos equipos en espejo se acepta ya que mejora el rendimiento de nuestros procesos.

Pregunta 4. Anexo “A”, características técnicas de los equipos, Química Clínica, punto 4: Que permita la carga de reactivos fríos al instrumento, en forma directa, sin necesidad de atemperarlos y sobre todo, que dicha carga pueda hacerse en cualquier momento del proceso

En la tecnología de Química seca hay ciertos reactivos que necesitan atemperarse, sin embargo, este proceso no afecta la continuidad del trabajo del laboratorio ya que el equipo tiene capacidad de tener reactivos abordo y de cargarlos en cualquier momento del proceso para iniciar a la rutina de trabajo. Además, el equipo muestra un inventario de los reactivos de todas las pruebas programadas.

Por lo que se solicita a la convocante que este punto sea opcional para el caso de la oferta de química seca. ¿Se acepta?

Respuesta 4. Se acepta, siempre y cuando no afecte los tiempos de procesos, y que esto sea demostrable en el manual del equipo.

Pregunta 5. Anexo “A”, características técnicas de los equipos, Química Clínica, punto 5: El equipo deberá procesar diferentes tipos de muestras como: suero, plasma, sangre total (sin necesidad de destapar el tubo o trasvasarlo), orina y liquido biológicos.

En la tecnología de química seca el pretratamiento que algunas pruebas requieren de esta tecnología representa la seguridad y exactitud del resultado, que el no hacerlo pudiera ocasionar resultados imprecisos por lo que solicitamos a la convocante que en la tecnología



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

de química seca algunas pruebas puedan ser pretratadas. Solicitamos a la convocante permita ofertar una tecnología que dependiendo de la prueba y del tipo de muestra sea necesario o no el transvase, ya que esta no es una característica que impacte en la calidad del resultado ¿se acepta?

Respuesta 5. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 6. Anexo “A”, características técnicas de los equipos, Química Clínica, punto 12: Los reactivos deberán estar en presentación listos para su uso de igual manera os calibradores y controles deberán de encontrarse listos para su uso. En el caso de controles y calibradores liofilizados su tiempo hidratación no deberá ser mayor a 30 minutos y su estabilidad ya hidratados no deberá ser menor a una semana.

Solicitamos atentamente a la convocante considerar que en el caso de la química seca los calibradores reconstituidos con estabilidad por 24 horas se utilizan así porque el equipo ofertado no requiere re-calibraciones , debido a que las calibraciones son estables por 6 meses o hasta el cambio de lote, siendo esta una de las principales ventajas de la tecnología y haciendo que no sea necesario que se mantengan por una semana, por lo que solicitamos a la convocante que esta característica se pueda colocar la leyenda “no aplica” en caso de ofertar química seca únicamente en lo que se refiere a los calibradores ¿se acepta?

Respuesta 6. Se acepta, siempre y cuando se comprometan a tener lotes que duren los 6 meses.

Pregunta 7. Anexo “A”, características técnicas de los equipos, inmunología punto 2: El equipo deberá ser 100 % automatizado para análisis de inmunoensayos y su capacidad promedio de procesamiento deberá ser de 300 pruebas o más por hora para Chihuahua y 90 pruebas o más por hora para Juárez.

¿Es correcto entender que la capacidad de 300 pruebas por hora para Chihuahua, se refiere a la suma de la productividad de los dos equipos solicitados para esta delegación?

Respuesta 7. Se solicitan dos equipos para tener uno de respaldo ya que en ocasiones la atención técnica puede tardar más de 4 horas y detiene el trabajo del área, pero si se proponen dos equipos en espejo se acepta ya que mejora el rendimiento de nuestros procesos.

Pregunta 8. Anexo “A”, Propuesta técnica, características técnicas de los equipos, inmunología punto 5: El tiempo de obtención de resultados por prueba deberá ser de 18 minutos a 35min máximo.

En las metodologías de inmunología por sistemas automatizados los tiempos de incubación representan la certeza del desarrollo de las reacciones antígeno-anticuerpo y en donde el tiempo de incubación es realmente un requisito indispensable en todos los sistemas, siendo la velocidad de la realización de las pruebas por hora en los sistemas lo que representa la importancia en la entrega de los resultados. En nuestra tecnología, dependiendo del tipo de ensayo que se trate los tiempos de incubación pueden variar de 18 a 43 minutos.





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Por lo cual se le solicita atentamente a la convocante no considerar los tiempos de incubación para los resultados obtenidos, siendo que se cumpla con la velocidad de pruebas por hora indicadas en el punto 2. ¿Se acepta?

Respuesta 8. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 9. Punto 7. Todos los equipos deberán de contar con un programa (software y hardware) para control de calidad interno completo, que permita el almacenamiento de todos los datos de los controles de por lo menos un año, y la introducción y uso de multireglas Westgard, que presente gráficas de Levy Jennings. El software del equipo deberá incluir el idioma español y ser accesible al usuario, el ingreso de información técnica deberá ser mediante descarga vía electrónica.

¿Es correcto entender que este punto se puede cubrir considerando el sistema de control de calidad interno de los equipos y el sistema informático al cual se comunicaran los equipos ofertados?

Respuesta 9. Es correcta su apreciación.

Pregunta 10. Anexo “A”, características técnicas de los equipos, Sistema pre-analítico punto 2.6: Almacenamiento/refrigerado

¿Es correcto entender que el almacenamiento refrigerado se refiere a las muestras ya clasificadas por gradilla para ser almacenadas pudiendo colocar un refrigerador adicional para este propósito?

Respuesta 10. Es correcta su apreciación.

Pregunta 11. Anexo “A”, PRUEBAS DE LABORATORIO, QUÍMICA CLÍNICA.

Solicitamos a la convocante que aquellas pruebas cuya demanda mensual sea menor a 100 pruebas mensuales, se acepte que a decisión del licitante se puedan ofertar para procesarse en un laboratorio de referencia o procesarse en los equipos en sitio ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta 11. Se acepta, siempre y cuando el tiempo de entrega de resultados al área de laboratorio no exceda 5 días hábiles, no requiera muestras adicionales al derechohabiente, así mismo se deberá coordinar con las jefaturas de laboratorio para definir el proceso de subrogación y que éste no amerite una demanda adicional de tiempo de trabajo para el personal del área, condicionado a que si aumenta la cantidad de estudios se puedan procesar en los equipos instalados.

Pregunta 12. Anexo “A”, PRUEBAS DE LABORATORIO, INMUNOLOGÍA



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Solicitamos a la convocante que aquellas pruebas cuya demanda mensual sea menor a 100 pruebas mensuales, se acepte que a decisión del licitante se puedan ofertar para procesarse en un laboratorio de referencia o procesarse en los equipos en sitio ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta 12. Se acepta, siempre y cuando el tiempo de entrega de resultados al área de laboratorio no exceda 5 días hábiles, no requiera muestras adicionales al derechohabiente, así mismo se deberá coordinar con las jefaturas de laboratorio para definir el proceso de subrogación y que éste no amerite una demanda adicional de tiempo de trabajo para el personal del área, condicionado a que si aumenta la cantidad de estudios se puedan procesar en los equipos instalados.

Por parte de INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1. Pregunta; el licitante ganador deberá proporcionar e instalar equipos en un tiempo acordado en conjunto con la institución, pero acorde en los tiempos máximos después de la emisión del contrato, solicitamos amablemente a la institución que los tiempos sean de 8 semanas para los de seis, para los de 4 semanas que sean 6 semanas y para los 3 y 2 semanas sean de cuatro semanas:

Respuesta 1. Se acepta su propuesta, siempre y cuando el proveedor garantice la continuidad del servicio de laboratorio durante el tiempo adicional solicitado.

Pregunta 2. SISTEMA PRE-ANALÍTICO 2.4 Distribución.

Pregunta: ¿se solicita a la convocante aclarar el punto, si se refiere a la necesidad de clasificar los tubos en los diferentes racks para luego ser transportados por el personal a los diferentes analizadores?

Respuesta 2. Se refiere a que existan bandas transportadoras que lleven las muestras a área de centrifugado, área de destaponador, de ahí las lleve a los equipos para su proceso y una vez procesada la muestra se encargue de tapar las muestras y colocarlas en racks o charolas para su almacenamiento.

Pregunta 3. SISTEMA PRE-ANALÍTICO. 2.6 ALMACENAMIENTO/REFRIGERADO.

Pregunta: Se solicita a la convocante sobre el punto para almacén en frío y archivo de muestras que se refiere al clasificado de racks luego del proceso, el personal se encargará del almacenamiento según sus protocolos de calidad. ¿es correcta nuestra apreciación?



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta 3. Es correcta su apreciación.

Pregunta 4. HEMATOLOGIA. 1. El equipo deberá de contar con una biometría de mínimo 31 parámetros que incluya un diferencial de cinco partes, que cuente con cualquiera de las siguientes características: sistema de impedancia, láser, citometría de flujo, fluorescencia y enfoque hidrodinámico.

Pregunta: ¿Es correcto entender, que para el punto 1, se solicita un equipo que cuente con una biometría hemática con 31 parámetros incluyendo diferencial de 6 partes incluyendo granulocitos inmaduros?

Respuesta 4. Es correcta su apreciación.

Pregunta 5. UROANALISIS. 3. La tira reactiva deberá tener como mínimo diez parámetros para determinar de química urinaria, gravedad específica, color y claridad. La determinación de los analitos deberá incluir (Densidad específica, pH, bilirrubinas, glucosa, cetonas, sangre, proteínas, urobilinógeno, nitrito, leucocitos, color y claridad).

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante, adicional a estas especificaciones, que la tira reactiva debe contar con una malla yodada, para un mejor resultado apegado a los criterios de calidad.

Respuesta 5. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 6. ¿Cómo sería la comunicación entre el sistema de Hospital y sistema de laboratorio (Web Service, HL7, Archivo, etc.)?

Respuesta 6. Puede ser por HL7, archivo, comunicación directo de la base de datos o web service.

Pregunta 7. ¿Nos proporcionarían los catálogos para hacer la configuración del sistema?

Respuesta 7. Sí, es correcto. se proporcionarán los catálogos requeridos para interfaz de los equipos con nuestra base de datos en oracle para la transferencia de órdenes y resultados.

Pregunta 8. ¿Se migrará información del sistema anterior?



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta 8. No es necesario migrar información, ya que el sistema usado en laboratorio no se cambiará. Los equipos o analizadores deberán contar con un software/base de datos para recibir las ordenes y a su vez transferir los resultados a nuestro sistema.

Pregunta 9. ¿Nos proporcionarían el internet para el envío de resultados pacientes?

Respuesta 9. No se requiere internet para el envío de resultados, éstos se envían al sistema/base de datos de laboratorio, no se envían directo al paciente. la conexión entre nuestro sistema y los equipos se debe realizar a través de la red local.

Pregunta 10. ¿A que refieren con Medias movibles?

Respuesta 10. Que el personal químico pueda establecer su propia media en los equipos determinada por los valores obtenidos en un tiempo determinado.

Pregunta 11. ¿A qué se refiere con criterios de dilución? ¿Se refiere a que el equipo analítico tenga la facultad de realizar la dilución o que el software (sistema) tenga la facultad de indicarle al equipo analítico la dilución deseada?

Respuesta 11. Que el software tenga la facultad de indicarle al equipo la dilución deseada.

Pregunta 12. En el anexo A, REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, 2. EQUIPAMIENTO, en la parte de equipo de laboratorio para el equipamiento de Química Clínica e Inmunología de la Delegación de Chihuahua, se menciona un tiempo Máximo de 6 semanas, solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar con un adicional de 10 semanas a las ya mencionadas con el objetivo de poder hacer la implementación de forma correcta.

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta 12. No se acepta su propuesta, ya que el tiempo de proceso de laboratorio no puede ser detenido.

Pregunta 13. En el anexo A, REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, 2. EQUIPAMIENTO, en la parte de equipo de laboratorio para el equipamiento de Química Clínica e Inmunología de la Delegación de Juarez, se menciona un tiempo Máximo de 4 semanas, solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar con un adicional de 8 semanas a las ya mencionadas con el objetivo de poder hacer la implementación de forma correcta.

¿Se acepta nuestra solicitud?



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta 13. No se acepta su propuesta, ya que el tiempo de proceso de laboratorio no puede ser detenido.

Por parte de **LABORATORIOS SAN ÁNGEL S.A.:**

Pregunta 1. PROPUESTA TECNICA, NUMERO 16, PÁGINA 11 DE 19

Dice: 16. Copia simple del registro sanitario ante la secretaria de salud (anexos y última modificación) para la comercialización de cada uno de los productos, consumibles y equipos a licitar, de conformidad con los artículos 376 y 376 bis de la ley general de la salud. Considerando que los anexos pertenecientes a el trámite de un registro sanitario son demasiadas páginas, solicitamos amablemente a la convocante que para cumplir con este punto bastara con presentar el registro sanitario, prorroga de registro sanitario o modificación. ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta 1. No se acepta, se requiere el registro sanitario de manera completa con toda la información que proporcione a la convocante las especificaciones de los insumos y caducidades.

Pregunta 2. INSTALACION, PÁGINA 5 DE 24

Dice: dentro de la propuesta técnica ofertada, el licitante deberá presentar un listado cualitativo y descriptivo de los equipos e instrumentos con los que se brindará el servicio de laboratorio clínico, considerando en la descripción, cantidades, nombre del equipo, marca, modelo, características generales, requisitos de instalación (hidráulica, eléctrica, informática, etc.) Requisitos de funcionamiento y mantenimiento, mapa de ubicación del equipo y los estudios específicos que se pretenden realizar con cada dispositivo. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a que se refiere con “mapa de ubicación del equipo” o que nos facilite los planos del laboratorio donde instalaremos en caso de ser adjudicados para poder realizar lo solicitado.

Respuesta 2. A la guía mecánica del equipo en caso de que aplique.

Pregunta 3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS, QUIMICA CLÍNICA (SECA O HÚMEDA), PAGINA 12 DE 24.

Que permita la carga de reactivos fríos al instrumento, en forma directa, sin necesidad de atemperarlos y, sobre todo, que dicha carga pueda hacerse en cualquier momento del proceso. Solicitamos amablemente a la convocante que esta característica sea opcional, para no afectar la libre participación. ¿se acepta?



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta 3. Se acepta siempre y cuando la carga y descarga de reactivos no afecte el proceso de las muestras una vez que el equipo se encuentre en funcionamiento.

Pregunta 4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS, UROANALISIS, PAGINA 14 DE 24

Los controles y calibradores deberán de estar en estado líquido y/o liofilizado. Solicitamos amablemente a la convocante que esta característica sea opcional para no afectar la libre participación. ¿se acepta?

Respuesta 4. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS, EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOSEQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS, PAGINA 15 DE 24.

Por método de inmunocromatografía. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo que trabaje por inmunofluorescencia, para no afectar la libre participación ya que este método es característico de un fabricante. ¿se acepta?

Respuesta 5. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 6. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS, EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOSEQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS, PAGINA 15 DE 24.

Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automático de aguja. Solicitamos amablemente a la convocante que esta característica sea opcional, con la finalidad de no afectar la libre participación. ¿se acepta?

Respuesta 6. Se acepta sin ser limitativa.

Pregunta 7. ANEXO “A”, 2. EQUIPAMIENTO, TIEMPO MAXIMO DE INSTALACION, PAG. 3 DE 24

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita realizar la instalación de los equipos en un periodo de 90 días como tiempo máximo para no limitar la libre participación, ya que es un tiempo adecuado para la importación de los equipos, las adecuaciones e instalaciones. ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta 7. No se acepta su propuesta, ya que el tiempo de proceso de laboratorio no puede ser detenido.

Pregunta 8. ANEXO “A”, 2. EQUIPAMIENTO, TIEMPO MAXIMO DE INSTALACION, PAG. 3 DE 24.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Para el equipo pre-analitico solicitamos amablemente a la convocante nos otorgue un tiempo de instalación y puesta en marcha de 18 semanas, ya que el equipo es nuevo y el tiempo de importación y puesta en marcha requiere del tiempo solicitado, sin que esto afecte a la unidad médica.

¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta 8. No se acepta su propuesta, ya que el tiempo de proceso de laboratorio no puede ser detenido.

Pregunta 9. ANEXO “A”, 2. EQUIPAMIENTO, TIEMPO MAXIMO DE INSTALACION, PAG. 3 DE 24

Para el equipo de automatización solicitamos amablemente a la convocante nos otorgue un tiempo de instalación y puesta en marcha de 18 semanas, ya que el equipo es nuevo y el tiempo de importación y puesta en marcha requiere del tiempo solicitado, sin que esto afecte a la unidad médica. ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta 9. No se acepta su propuesta, ya que el tiempo de proceso de laboratorio no puede ser detenido.

Se aperece a todos los licitantes que deseen participar en la presente licitación, que todas las aclaraciones, dudas y cambios realizados emanadas de esta junta de aclaraciones serán obligatorias y serán consideradas para la integración de las propuestas técnica y económica y la evaluación de las mismas, bajo pena de no cumplir con ellas, de desechar sus propuestas por no cumplir con los requisitos solicitados por la presente.

No habiendo más aclaraciones que realizar, se da por concluida la primera Junta de Aclaraciones, siendo las 12:20 horas del día 6 de mayo de 2022, firmada de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar, entregando copia de la misma, para su debida constancia y efectos de notificación.

**LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES
CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:**

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO
PARA SU PROCESAMIENTO"

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

VOCAL

L.A.F. LUIS CARLOS PAYÁN ARMENDÁRIZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS

VOCAL

LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ
MELÉNDEZ
COORDINADOR JURÍDICO

VOCAL Y REQUIRENTE

DRA. ALICIA ANDREA RIVERA MORALES
EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR MÉDICO

EN CALIDAD DE OBSERVADOR

LIC. RICARDO DE JESÚS PÉREZ PEÑA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO




PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-013-2022-BIS
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO”

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTES

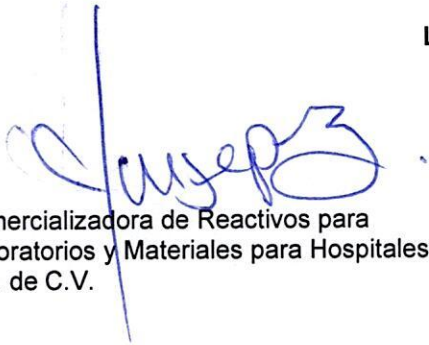

Comercializadora de Reactivos para
Laboratorios y Materiales para Hospitales,
S.A. de C.V.

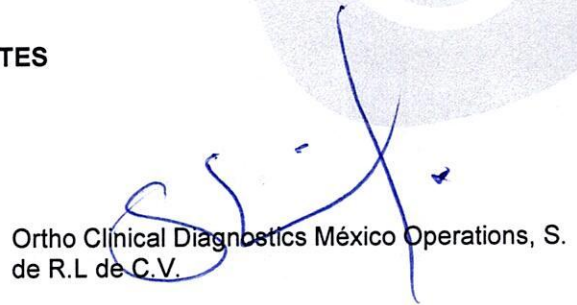

Ortho Clinical Diagnostics México Operations, S.
de R.L de C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2022, EN EL PROCESO LICITATORIO PÚBLICO PRESENCIAL NÚMERO PCE-LPP-013-2022-BIS, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPO PARA SU PROCESAMIENTO.

